Inkubator 8000 SC

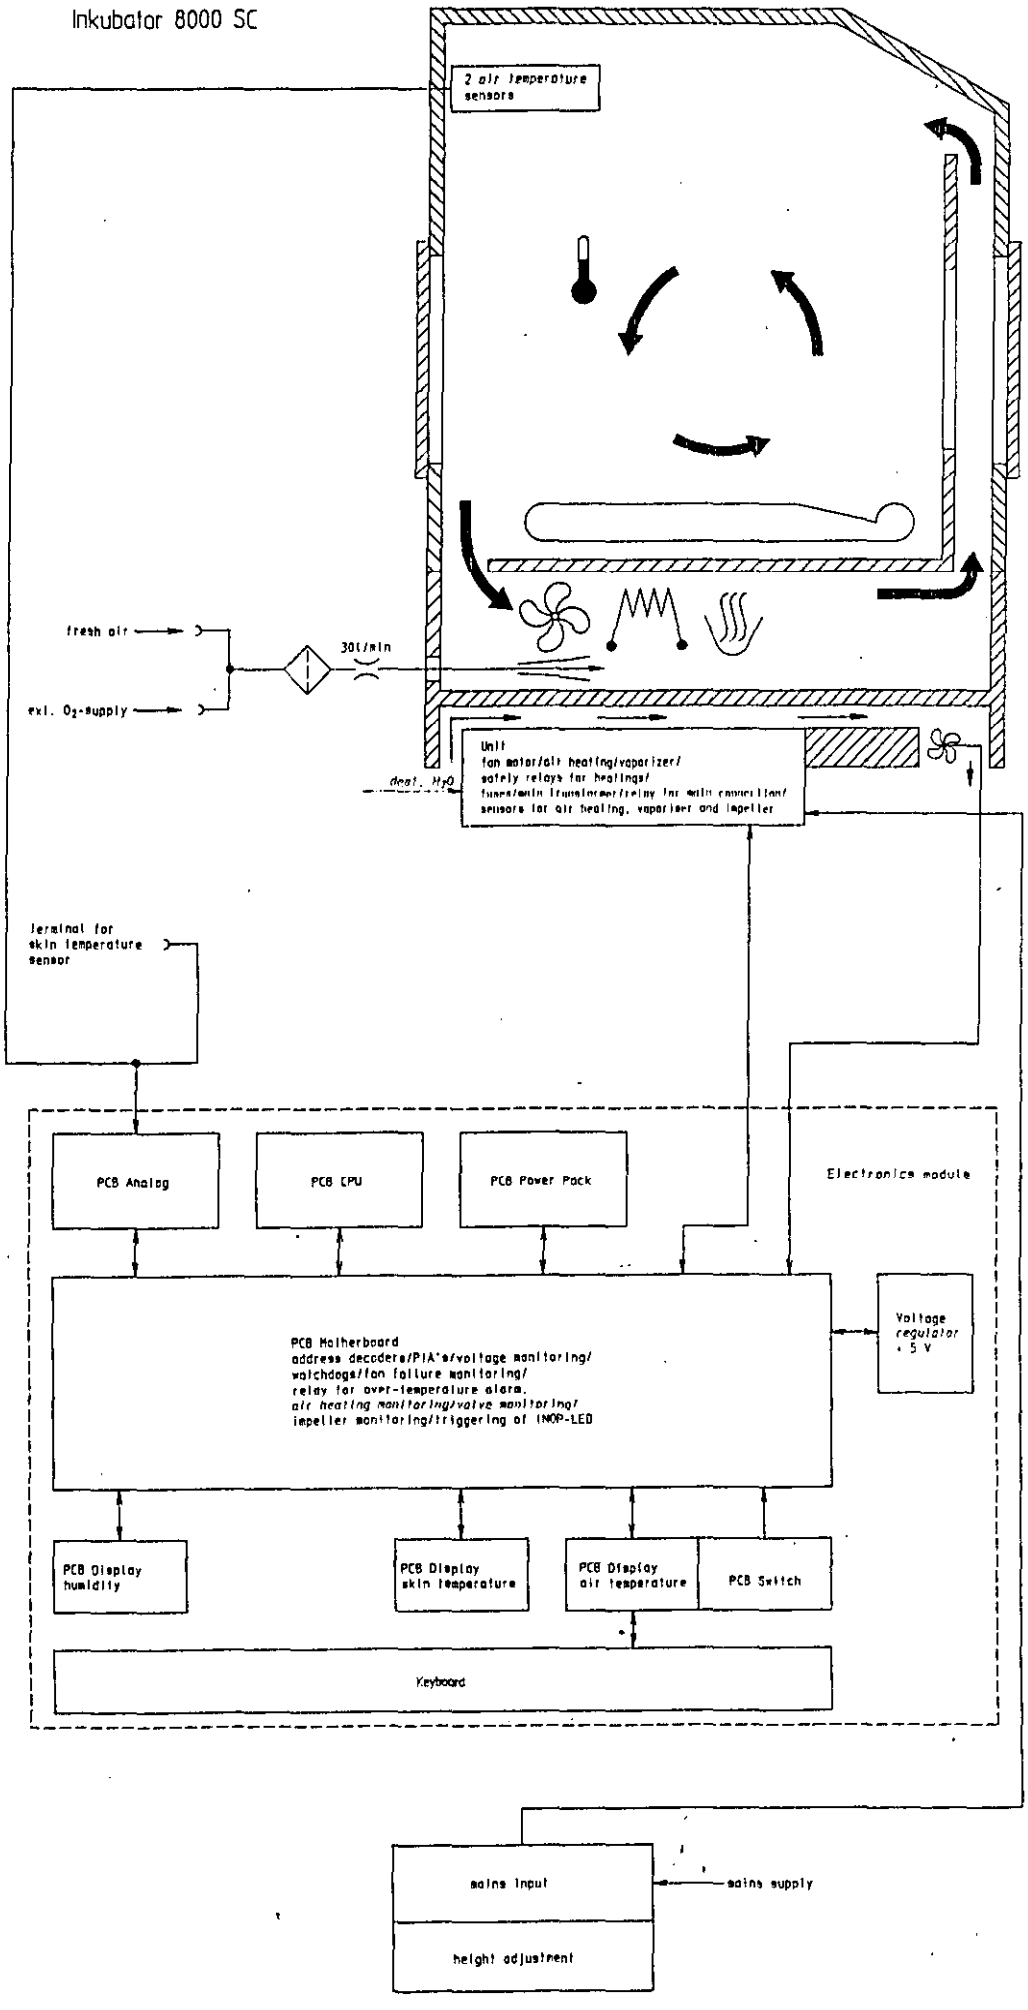

(B)

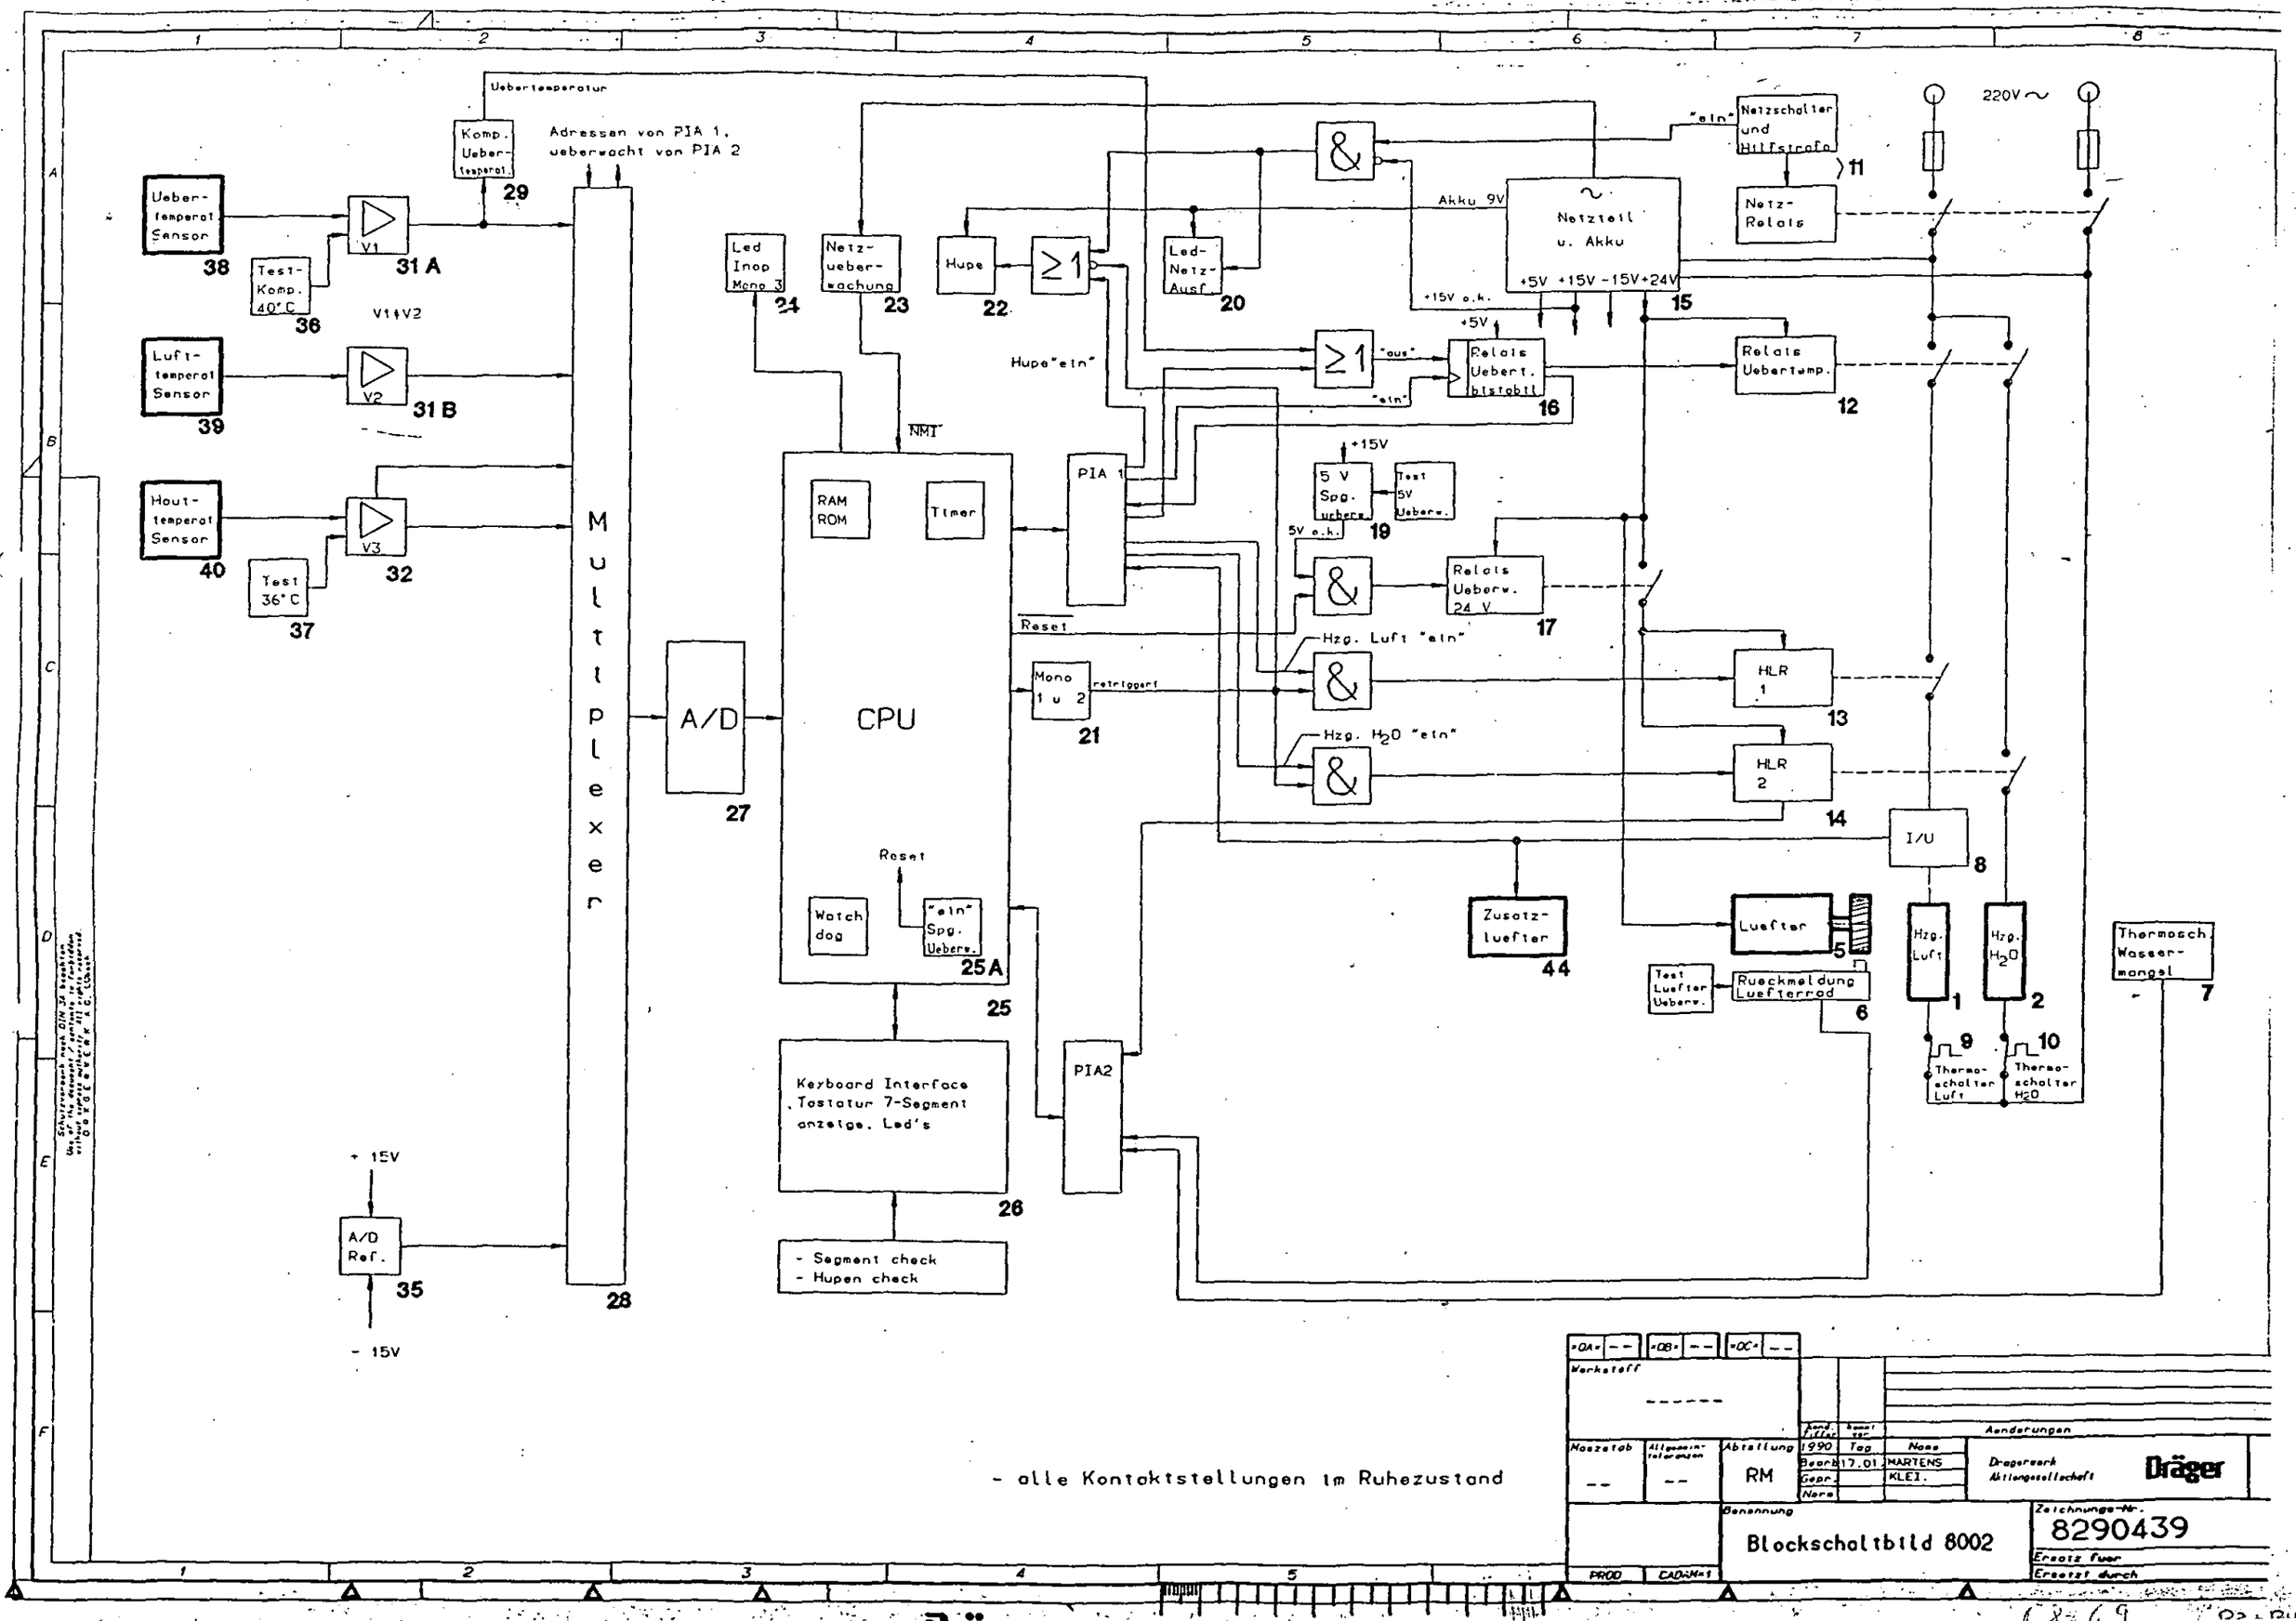
Uebertemperatur
Komp. Uebertemperat.
29
Adressen von PIA 1, ueberwacht von PIA 2
Uebertemperat Sensor
38
Test-Komp. 40°C
36
V1
31 A
V1+V2
Luft-temperat Sensor
39
V2
31 B
Haut-temperat Sensor
40
Test 36°C
37
V3
32
Multiplexer
28
A/D
27
CPU
RAM ROM
Timer
NMI
Reset
Watch dog
"ein" Spg. Ueberw.
25A
25
Keyboard Interface, Tastatur 7-Segment anzeige, Led's
26
- Segment check
- Hupen check
PIA 1
PIA2
Led Inop Mono 3
24
Netz-ueber-wachung
23
Hupe
22
≥1
Hupe "ein"
Led-Netz-Ausf.
20
Mono 1 u 2
retriggert
21
Reset
+ 15V
A/D Ref.
35
- 15V
Akku 9V
Netzteil u. Akku
+5V +15V -15V +24V
15
+15V o.k.
+5V
"aus"
"ein"
Relais Uebert. bistabil
16
5 V Spg. ueberw.
19
Test 5V Ueberw.
5V o.k.
Relais Ueberw. 24 V
17
Hzg. Luft "ein"
Hzg. H2O "ein"
"ein"
Netzschalter und Hilfstrafo
11
Netz-Relais
220V ~
Relais Uebertemp.
12
HLR 1
13
HLR 2
14
I/U
8
Zusatz-luefter
44
Luefter
5
Test Luefter Ueberw.
Rueckmeldung Luefterrad
6
Hzg. Luft
1
Hzg. H2O
2
Thermosch. Wasser-mangel
7
9
Thermo-schalter Luft
10
Thermo-schalter H2O
- alle Kontaktstellungen im Ruhezustand
Werkstoff
Massstab
Allgemeintoleranzen
Abteilung
RM
Aenderungen
Name
MARTENS
KLEI.
Benennung
Blockschaltbild 8002
Zeichnungs-Nr.
8290439
Ersatz fuer
Ersetzt durch
Dräger
Drägerwerk Aktiengesellschaft